


=====
操作者 : 系统 序列行 : 9
仪器 : hplc 位置 : 样品瓶 93
进样日期 : 2017/7/24 19:32:50 进样次数 : 3
进样量 : 1.000 µl
方法 : D:\CHEM32\1\DATA\DEF_LC 2017-07-24 15-38-18\TEMP 5-95.M (序列方法)
最后修改 : 2017/7/24 15:38:18 : 系统
附加信息: 峰被手动积分

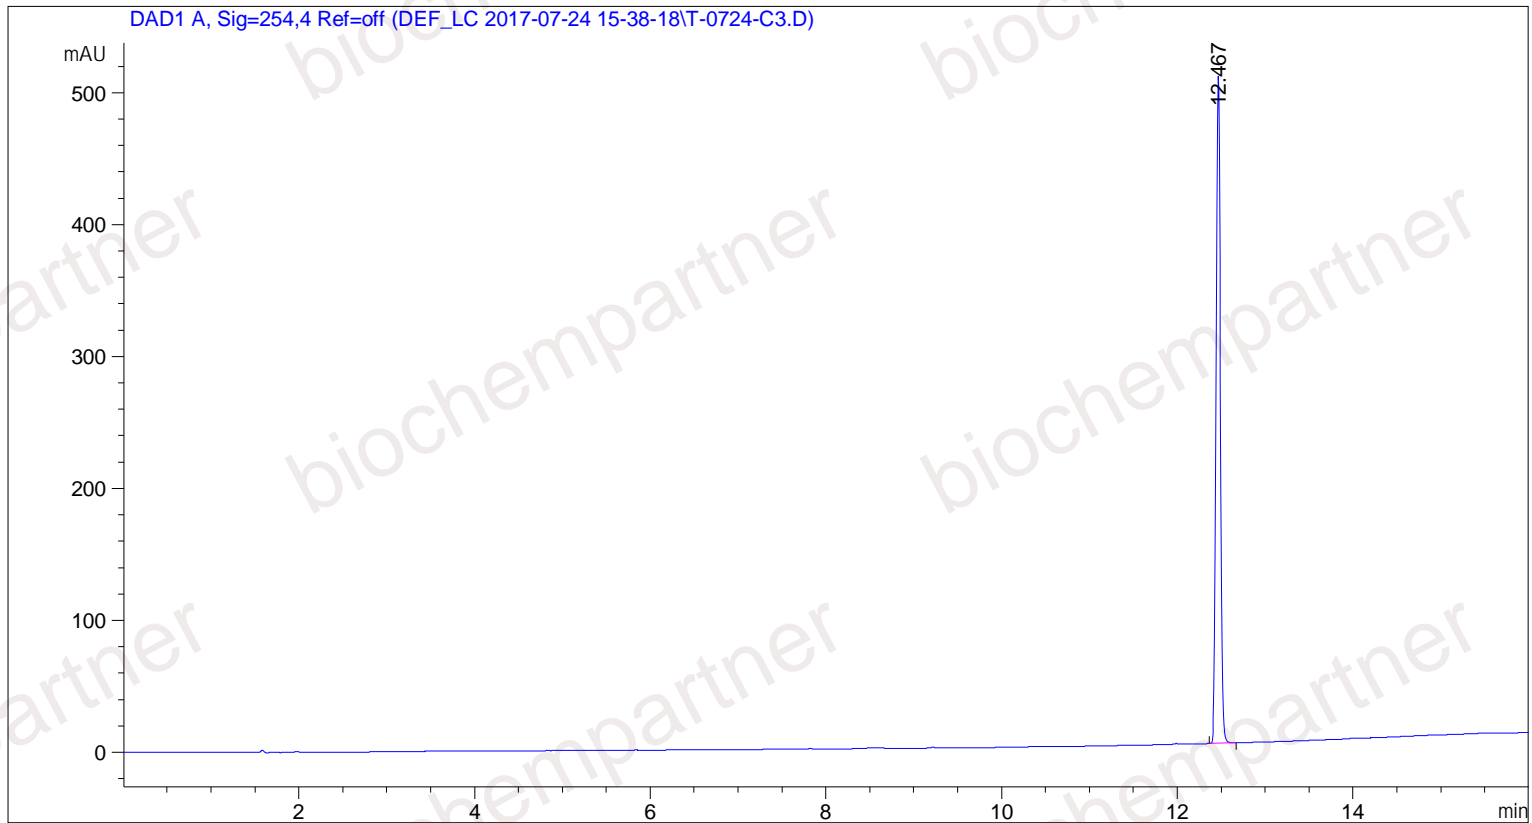

=====
面积百分比报告
=====

排序 : 信号
乘积因子 : 1.0000
稀释因子 : 1.0000
内标使用乘积因子和稀释因子

信号 1: DAD1 A, Sig=254,4 Ref=off

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	12.467	BB	0.0535	1716.53577	507.03598	100.0000

总量 : 1716.53577 507.03598

=====
*** 报告结束 ***